

BY 70

beurer
babycare



15 משאבת חלב

2 מדריך הפעלה

16 Electromagnetic Compatibility
Information

CE 0483



קראו הוראות שימוש אלה בקפידה ושמרו אותן לשימוש בעתיד,
אנא וודאו כי יהיו נגישות למשתמשים אחרים ושימו לב למידע שהן מילוט.



תוכן העניינים

1. סימנים וסמלים	3
2. הכירו את המכשיר שלכם	4
3. השימוש לשמו נועד מכשיר זה	4
4. העורט	4
5. תיאור המכשיר	6
6. שימוש ראשוני במכשיר	7
7. הרכבת משאבת החלב	8
8. ניקוי ועיקור משאבת החלב	9
9. הפעלה	9
9. טיפים להבטחת זרימת חלב טוביה יותר	9
9. הפעלת משאבת החלב	7.2
11. הפעלת משאבת החלב	7.3
12. השימוש במשאבה ידנית	7.4
12. אחסנת חלב האם השאב	7.5
13. הזנה באמצעות חלב אם	7.6
13. מה לעשות במקרה ואתנו נתולות בעיות	8
14. חלקיק חילוף וחלקים שחוקים	8.1
14. השלכת המוצר	9
10. נתוניים טכניים	14
11. חלקים מרכזים	15

הדברים הכלולים במשלוח המוצר

- משאבת חלב (יחידת מנוע)
- צינורות סיליקון עם מתאם לשאייה זו צדדיות
- צינור סיליקון לשאייה חד צדדי
- 2 x חיבור משאה עם מבנה סיליקון ושתום סיליקון
- 2 x כירית סיליקון (גודל רגיל)
- 2 x בקבוקים
- 2 x מכסים לבקבוקים
- פטמת סיליקון
- מכסה לבקבוק עבורי פטמת הסיליקון
- משאה ידנית
- 2 x מחזק בקבוקים קטן
- 2 x מתאם לבקבוקי Avent וNUK
- שקיית אחסנה
- תקע חשמל
- 4 x סוללות AA
- הוראות שימוש אלה

אנו מודים לך על שבחת באחד המוצרים שלנו. המותג שלנו מייצג מוצרים איכותיים מתקנים היבש: המותג מעונן על ידי חדשות ובטיחות. מגוון המוצרים שלנו כוללים שפע של מוצרים המיועדים לביריאות ולרוחה בתchrom הטיפול בחום, משקל, לחץ דם, טמפרטורת גוף, דופק, טיפול עדין, עיסוי, אויר וטיפול בתינוק. קראו להוראות שימוש או לא בקפידה ושמרו אותן לשימוש עתידי, וזאת שההוראות השימוש יהיו זמינים למשתמשים אחרים ושימנו לב למידע הכלול בהן.

ברכה,
צוות Beurer שלך

1. סימנים וסמלים

הסמלים הבאים מופיעים בהוראות שימוש אלה:

	זהירות הוראות זהירות המצינית סכנה לפגיעה או לנזק בבריאות
	חשוב לדעת הודעת בטיחות המצינית נזק אפשרי למכתיר/לאבזר
	הערה הערה לגבי מידע חשוב
	שימוש לב להוראות השימוש
	חלק יישומי, סוג BF
— — —	זרם ישיר
	השלכת המוצר בהתאם לתיקון WEEE-EC (השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני).
	יצור
	טמפרטורת ולחות הפעלה מותרות
	טמפרטורת ולחות אחסנה מותרות
IP 21	מוגן מפני גופים זרים השווים או גדולים יותר מ-12.5 מ"מ בקוטרם ומפני נפילה אנטית של טיפות מים.
1935/2004	מצין כי המארז מכיל מוצריים המיועדים לבוא בגע עם מזון בהתאם לתיקון (EC) מס' 1935/2004.
	מספר סידורי
	תוויות CE מאשרת כי המוצר תואם אתדרישות ההכרחות של תיקון EEC/93/42 המתקשר למוצרים רפואיים.
	מספר קטלוגי של יצור
	המכתיר כולל הגנה כפולה ותואם את הגנה סוג 2.

2. הכירו את המכשיר שלכם

משابت החלב דגם 60 BY TZURAT Beurer מאפשרת לאימהות מניקות לשאוב את חלב האם שלhn בקלות ובונחות בביטחון. במידה ולא נשابت כמות מספיק גודלה של חלב אם מאיימות שזה עתה ילו', הדבר עלול לגרום להצטברות חלב מלאהocabim, שבמקרה הגרוע ביותר עלול לגרום לדלקת של הפוטמוס (דלקת בשדיים). ניתן למנוע הצטברות חלב זו באמצעות שאייבת שזיה עתודה, בעודת משאבת החלב.

גופס על נך, משאבת חלב מסוימת בהפקת פטומות סדוקות או דלקתיות. באפשרותן לעשיות שימוש בפונקציית האגירה המשולבת על מנת להוציא פטומות שטוחות או הופכות, מה שמקל את פעולה משאייבת החלב האם. משابت החלב מאפשרת לנו גם לאחסן חלב בבקבוק, לדוגמא במרקם בהם אתן נמצאות בנסעה או הרחק מתינוקן למשר פרק זמן ממושך.

תינוקות שאינם יכולים לנוק שירות מהשד מסיבות בריאותיות (בשל לידה מוקדמת או אחרת שסוע) יכולים עדין לקבל חלב אם באמצעות שימוש בשאייבת החלב.

3. השימוש לשמו נועד מכשיר זה

במשابت החלב יש לשאוב את חלב אם מאיימות מניקות. אין לעשות שימוש במשابت החלב עם בעלי חיים. משابت החלב מיועדת לשימוש ביתי/פרטי בלבד, ולא לשימוש מסחרי. מכשיר זה מותר לשימוש למטרה לשמה נועד ובאופן המצוין בהוראות השימוש. שימוש לא נכון במכשיר זה עלול להיות מסוכן. היצן אינו אחראי לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה משימוש לא נכון או רשלני במכשיר.

4. הערות



הערות בטיחות

- הרחיקו חומר אריזה מהישג ידם של ילדים וזאת במטרה למנוע סכנה לחנק.
- הרחיקו חלקים קטנים מהישג ידם של ילדים.
- וודאו כי כבליים וצינורות אינם נגשים לילדים.
- השתמשו אורך ו록 בcalculator הכלול במכשיר המוצר.
- חל אסור על ילדים לשחק עם המכשיר.
- ניקיון ותחזוקה של המש坦ש לא יבוצע על ידי ילדים אלא אם כן הושמה עלייהם השגחה.
- אין למשוך, לעקם או לכופף את כבל החשמל.
- טרם השימוש במשابت החלב בפעם הראשונה, וודאו כי המפרטים הטכניים של תקע החשמל תואמים לאלו של יחידת המנוח.
- הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל במרקם של תקללה תפעולית, טרם ניקוי המכשיר וכאשר המכשיר אינו בשימוש.
- חל אסור על משابت החלב לבוא מגע עם משטחים חמימים או חפצים בעלי קצוצות מחודדים.
- אין לעשות שימוש בכל חלק נוסף שאינו מומלץ על ידי היצן או מוצע עבורו.
- מסיבות של היגיינה, השימוש במשابت החלב ביחסו של תקע החשמל מותר על ידי אדם אחד בלבד. אין לחלק את משابت החלב עם איימות מניקות אחרות.
- במשابت החלב יש לעשות שימוש על שדיים של נשים בלבד.
- לעומת זאת, ניתן במשابت החלב במידה ואתן חשות רדומות או בזמן שינה.
- בזמן הפעלה במצב שאיבה "2", מותר השימוש בחיבור הציור עם המתאם עבור 2 בקבוקים קטנים בלבד.
- לעומת זאת, ניתן במשابت החלב בממדית או ממקלחת.
- במקרה של תקללה, אין לפתח או לנער את משابت החלב באמצעות מקרחה. עיניו בפרק המדבר על "מה לעשות במקרה של בעיות". במידה והבעיה שלכם אינה מתוארת כאן, אנא צרו קשר עם מרכז שירות הליקות או עם הספק שלכם.
- תיקונים יבוצעו על ידי מרכז שירות הליקות או ספקים מורשים בלבד. בשום מצב איןכם רשאים לפתח או לתקן את משابت החלב בעצמכם, כיוון שאין כל ערכות לתפקיד נטול תקלות לאחר מכן. חסור הייענות להנחה זו יגרום לביטול האחריות על המוצר.
- לעומת זאת, ניתן במשابت החלב בידיהם רטובות או לחות.
- לעומת זאת, ניתן במשابت החלב נפלת מים.
- לעומת זאת, ניתן במשابت החלב לאחר שנפלת לטור מים. הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל מיד במידה ומשابت החלב נפלת לטור מים.

- בעת השימוש במשabetת החלב, מקמו אותה על גבי משטח ישר ויציב.
- שחררו את כבל החשמל עד הסוף על מנת למנוע התכשומות יתר.
- לעולם אין למקם את משabetת החלב או את תקע החשמל של המכשיר בתוך מיקרוגל.
- הוציאו את תקע המכשיר משקע החשמל כאשר משabetת החלב אינה בשימוש. אין לעזוב את משabetת החלב מחוברת למקור חשמל.
- במקרה של כבל חשמל פגום של משabetת החלב, יש להשליכו לפח.
- לעולם אין לחם חלב אם בתוך מיקרוגל מכיוון שהוא עשוי להתחכם באופן לא שווה ועלול לגרום לכויה לילדך בזמן שהוא שותה אותן.
- הרחיקו את כבל החשמל ממשטחים חמימים.
- מכשיר זה אסור לשימוש על ידי אנשים הסובלים מבעיות גופניות, תחושתיות או שכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון או ידע בכל הנוגע לשימוש במיכיר זה.
- משabetת החלב אינה מצריכה כיל.
- אין לבצע שימושים במשabetת החלב או באבזרים שלה.

חשוב לדעת

- לעולם אין להרטיב את משabetת החלב במים. המכשיר אינו מוגן מפני התזוזות מים או נזלים. הרחיקו את משabetת החלב משודוט אלקטرومגנטיים חזקים, כיוון שהפרעה אלקטромוגנטית יכולה להתרחש ולה%;">שפיע לרעה על תפקוד משabetת החלב.
- הגנו על משabetת החלב ועל האבזרים שלה מפני פגימות, לחות, לכין, תנודות חזקות בטמפרטורה ומאור שימוש ישיר.
- אין למשוך את צינורות משabetת החלב.
- אין לעשות שימוש בכבול החשמל למשיכת תקע החשמל של המכשיר מחוץ לשקע החשמל.

חשוב לדעת

- הנחיות לגבי העברת הבקבוק למקום**
- בעת העברת חלב אם בתוך בקבוק (למשל: כאשר אתן בדרך או בסיסעה), אנה וודאו כי מכסה הבקבוק מוברג תמיד היטב לבקבוק ואוטם אותו.

אזהרה

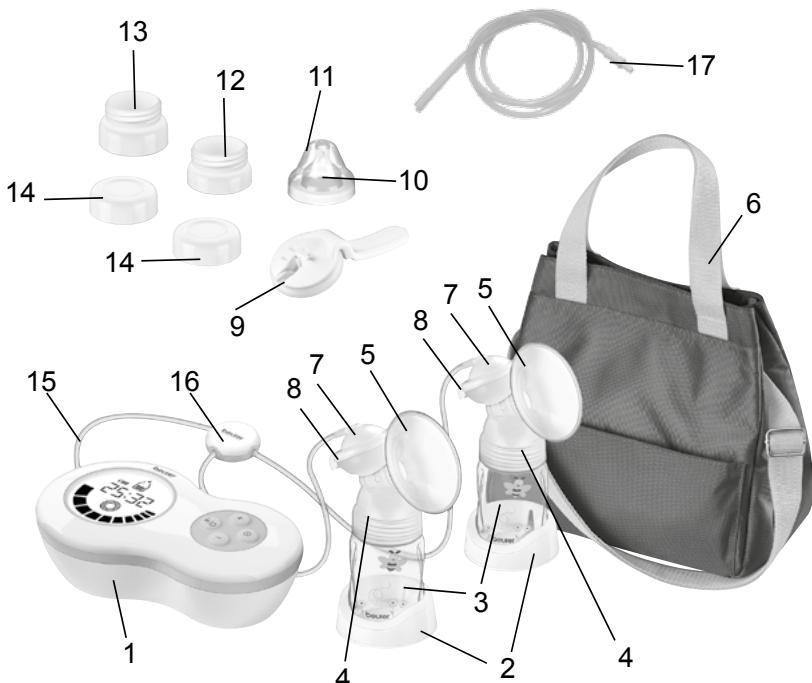
- ביטחונות הילד**
- מכשיר זה מותר לשימוש על תחת השגחה של אדם מבוגר בלבד.
 - הזנה מהפטמה ברצף ולמשך פרקי זמן ארוכים עלולה לגרום לרכיבון של השיניים.
 - השתמשו בפטמה להזנה, ולא בתור מוצץ.
 - תמיד בדקו את הטמפרטורה של החלב טרם האכלת התינוק.
 - בדקו את המכשיר לפני שימוש ונסחו את הפטמה בכל היכיונים.
 - השיליכו את הפטמה לפחות שמש ישיר או למקורות של חום ואין לעזוב אותה בחומר מוחטא (תמייסת חיטוי) במשך פרק זמן ארוך יותר מההומולז כיוון שהדבר עשוי לגרום לנזק לפטמה.
 - הרחיקו את הפטמה לפחות מתקנים מותקיים כיוון שהם עשויים לגרום לרכיבון בשיניים.
 - אין לעשות שימוש בחומרים שוחקים או בתכשירי ניקוי נגד חיידקים.
 - עקרו את כל החלקים הבאים ב מגע עם חלב האם בשער חמיש דקודות במים רותחים.
 - נקי את המכשיר לפני כל שימוש.
 - וודאו כי הטמפרטורה של הנוזל שבבקבוק לעולם אינה עולה מעל 50°C.

אזהרה

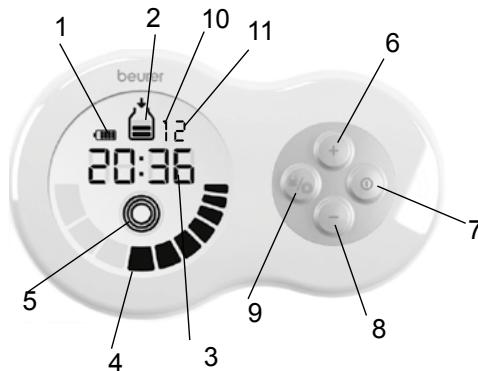
- הערות לגבי טיפול בסוללות**
- במדיה והעור או העיניים שלכן באים ב מגע עם נזול הסוללה, שטפו את האזוריים הנגועים במים וגשו לקבל טיפול רפואי.
 - סכנה לחנק! ילדים קטנים עשויים לבלווא את הסוללות להחנק מהן. אחסנו את הסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים!
 - שימוש לבסימוני הפלואס (+) והמיןוס (-) של הסוללות.
 - במקרה של דליפת סוללה, הלבישו כפפות הגנה ונקי את תא הסוללות במלילת יבשה.
 - הגנו על הסוללות מפני חום מוגזם.

- הגנו על הסוללות מפני חום מוגזם.
-  סכינה להתפוצצות! לעולם אין להשליך סוללות לתוך אש.
- אין להטען או לגורום קצר לסוללות.
- במידה ואין כוונה לעשות שימוש במכשיר במשך זמן ארוך יחסית, הוציאו את הסוללות מהתא הסוללות.
- השתמשו בסוללות חדשות או שווות ערך לסוללות המקוריות בלבד.
- תמיד החליפו את כל הסוללות בבת אחת.
- אין לעשות שימוש בסוללות נטענות.
- אין לפפרק, לפצל או למעורר את הסוללות.

5. תיאור המכשיר



1. משאבת חלב כולל צג	10. פטמה
2. מחזיק בקבוק קטן	11. מכסה לבקבוק
3. בקבוק קטן (180 מ"ל)	12. מתחם עבור בקבוקNUK (mAVENT) (NUK bottle holder)
4. שסתום סיליקון	13. מתחם עבור בקבוקNUK (mAVENT) (NUK bottle holder)
5. כרית סיליקון (גודל סטנדרטי)	14. תקע בורג לבקבוק
6. תיק נשיאה	15. צינור סיליקון עם מצב משאבה דואל'
7. חיבור משאבה כולל מכסה עם מעטפת סיליקון	16. צינור סיליקון עם מצב משאבה דואל'
8. מעטפת סיליקון	17. כבל חשמל
9. ידית משאבה ידנית הcolellת 2 דרגות	



7. לחץ ON/OFF	1. מצב הסוללה (להפעלה ללא תקע חשמל)
8. לחץ – (להפחיתת הגיריה או דרגת השאייה)	2. מצב שאיבה (לשאיות חלב אם)
9. לחץ MODE (החלפה בין מצב שאיבה למצב גיריה)	3. צג הזמן (טיימר לගיריה/משך זמן השימוש במצב שאיבה)
10. הגדרה לשאייה חד צדדיות (לחצו על + ועל – במקביל)	4. דרגת גיריה או שאיבה
11. הגדרה לשאייה דו צדדיות (לחצו על + ועל – במקביל)	5. מצב גיריה (לగירית הפטמה – לא נשאב חלב אם)
	6. לחץ + (להגברת דרגת הגיריה או השאייה)

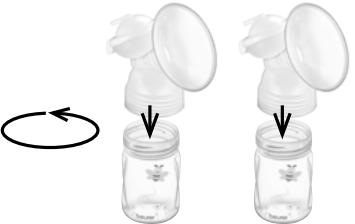
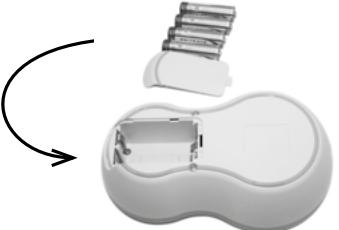
6. שימוש ראשוני במכשיר

הערה

בדקו כי לא התעסוקו בחומריו האזינה של משאבות החלב וודאו כי כל הרכיבים כוללים במאז. טרם השימוש,
וודאו כי אין נזק נראה לעין למיכשיר או לאבזרים וכי חומר האזינה הוסר. במקרה של ספק, אין לעשות שימוש
במכשיר ויש ליזור קשר עם הספק שכן או עם שירות לקוחות מסוים.

הרכבת משאבת החלב

ברגע שימושה המשאהת החלב הוצאה מהארץ, בדקו שמכלי הפלסטיק אינם מכילים סדקים וזאת על מנת לוודא כי הרכיבים החשמליים אינם חשופים לנוזלים ללא הגנה.

	<p>1. הבירגו את חיבור המשאהה לבקבוקים. וודאו כי חיבור המשאהה מחזק היטב כך שנוזל לא יוכל להימלט.</p>
	<p>2. הכניסו את צינורות הסיליקון לשאייה זו צדדיות לתוך 3 חיבורי המשאהה ומשאבת החלב</p>
	<p>3. לשאייה חד צדדי, הכניסו את צינור הסיליקון ללא מתאם לתוך חיבור המשאהה ומשאבת החלב.</p>
	<p>4. חבו את משאבת החלב לכבל החשמל הראשי והכניסו את תקע החשמל לתוך שקע החשמל.</p>
	<p>5. במידה ואתם בוחרים להפעיל את משאבת החלב בעזרת סוללות, פתחו את מכסה תא הסוללות שבצד האחורי של יחידת המונע. הכניסו ארבע סוללות AA (כלולות במשלוח). וודאו כי הסוללות מוכנסות בכוון הנכון. עינו בגרפייקה שבתא הסוללות. לאחר מכן, סגנו את תא הסוללות עד להышמע צלילי הקלקלה במקום. טעינת סוללה אחת עם ארבע סוללות AA תספיק להפעלה של 60 דקות לפחות (בגהדרה הנמוכה ביותר).</p>



נקו ועקו את החלקים הנפרדים של משאבת החלב הבאים במאגר ישר עם חלב אם (להוציא יחידת המנווע וצינור הסיליקון) בפרט טרם השימוש הראשוני בקבוקים ולפניהם כל שימוש נוסף. לעומת זאת ייחידת המנווע:

1. שחררו את הברגת חיבור המשאבה מהקבוק.
2. הוציאו את צינור הסיליקון מחיבור המשאבה ומיחידת המנווע.
3. הוציאו את מעתפת הסיליקון ואת שתותם הסיליקון מחיבור המשאבה.
4. חטאו את הקבקוקים ואת חיבור המשאבה (עם מעתפת סיליקון ושותם סיליקון) במשר חמוץ דקות במים רותחים או על ידי שימוש בקבוקים באמצעות אדים. אין לעשות שימוש במשאבת החלב עד שכל החלקים שלא יבשוו לחולוטן. אין לעשות שימוש במוצריכי ניקוי אנטיבקטריאליים, כיוון שגם עשויים לגרום נזק לפולסטיק של משאבת החלב.
5. נקו את יחידת המנווע בעזרת מטלית לחה במקצת בלבד. אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי או בחומר מימים. בשום מצב אין להחזיק את יחידת המנווע מתחת למים, כיון שהדבר יכול לנזול אליהנו תוך המכשיר ולגרום נזק למשאבת החלב. במידה ואין בכונתכם לעשות שימוש במשאבת החלב לשחק פרק זמן ממושך, הוציאו את הסולות.

7. הפעלה


7.1 טיפים להבטחת זרימת חלב טובת יותר

- בחרו מיקום לשימוש במשאבה בו תוכלי להרגיש משוחררת.
- בחרו בזמן לשימוש במשאבה כאשר ארת רגעה.
- מיקום לצד תינוקן או הסתכלות על תמונה של תינוקן יכולים להשפיע לחיבור על זרימת החלב.
- במקורה של הזנת ילדך משדר אחד, השתמשי במשאבת החלב לשאייבת השד השני במקביל.
- חום ורגיעה מעודדים זרימת חלב. השתמשי במשאבת החלב לאחר שעשית מקלחת או אמבטיה.
- במידה והשדיים שלך נפוחים או כאבים, הניחי מגבת חמה עליהם במשך מספר דקות. הדבר ישפר את זרימת החלב.
- במידה והחלב אינם מתחילה לזרום מהשדיים באופן מיידי, נסוי להירגע ולאחר מכן נסוי בשנית מספר דקות מאוחר יותר.
- במידה ומשאבת החלב אינה מוציאה חלב מהשדיים שלך לאחר חמוץ דקות, הפסיק את השימוש במכשיר ונסוי מאוחר יותר.
- במידה ואת חזהוocabים כבאים חדים בעקבות השימוש במשאבת החלב, היועצי עם רופא.

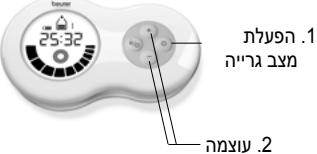
7.2 הפעלת משאבת החלב

א) הכנה לזרמת שאיבה דו צדדיות:

	<p>1. טרם השימוש במשאבת החלב, שטפו את הידיים ואת השדיים שלין ביסודות.</p>
	<p>2. משאבת החלב ו-2 הבקבוקים הקטנים חייבים להיות מחוברים לצינור הסיליקון עבור שאיבה דו צדדיות.</p>

	<p>3. שבו כאשר פלג הגוף העליון שלו כפוף מעט לפנים. אפשרותן לתרום טוב יותר בגין שלך באמצעות שימוש בכירית.</p>
	<p>4. מקמו את מגני השדיים עם כרית הסיליקון בעדינות על השדיים. וודאו כי הפטנות עטופות להלטין וכי אין כיסי אוור. על מנת להבטיח תפקוד נכון, מגני השדיים חיברים להיות מתחים היטב על השדיים.</p>
<p>1. הפעלת מבג גרייה 2. עצמה</p>	<p>5. להפעלת משאבת החלב, לחצו על לחץ . לאחר הפעלת משאבת החלב בפעם הראשונה, התוכנה תהיה מכוננת על מצב שאביה דו-איל "2". במהלך שתי הדקות אלה, הפטנות השדיים שלך יגורו במטרה להכין אותן לקראת שאיבת חלב האם. מצב זה "יבחר תמיד לשאייבת דו-צדדית". משאבת החלב תתחיל לפעול אוטומטית במצב גרייה  וטיימר של שתי דקות יופיע על גבי הצג. במהלך שתי הדקות אלה, הפטנת השד שלך תgorה במטרה להכין אותה לקראת שאיבת חלב האם. השתמשו בלחיצנים  /  לקביעת עצמת הגריה המבוקשת.</p>
<p>3. התחלת שאיבת השדרה 4. עצמה</p>	<p>6. לאחר שתי הדקות חלפו,  יתחל להבהב על גבי הצג. לתחילת שאיבת חלב האם, לחצו על לחץ . השתמשו בלחיצנים  /  לביצוע עצמת הינקה הנוכחית לך. הפסיקו את השימוש במשאבת ברגע שנცברו 180 מ"ל של חלב לתוכן הקבוקים.</p>
<p>5. חזרה למצב גרייה</p>	<p>7. במידה וברצונך לחזור למצב גרייה, לחצו על לחץ . הגרייה והטיימר של שתי הדקות יתחלו לפעול מהתחלה. משאבת החלב יש פונקציית זיכרון, החזורת את דרגת הגרייה או את דרגת השאייבה الأخيرة שתונכנתה כאשר הופעלה.</p> <p>נא שימו לב: מצב השאייבה החד צדדיות "1" או מצב השאייבה הדואלית "2" יוחסנו גם כן. במצב שאיבת דו-איל "2", יש לחבר את המתאם הדו צדיי ליחידת המנוע.</p>
<p>8. לכיבוי משאבת החלב, לחצו על לחץ .</p>	

7.3 הפעלת משאבת החלב
(ב) הכנה לקרהת שאיבה חד צדדי:

	<p>1. טרם השימוש במשאבת החלב, שטפו את הידיים ואת השדיים שלכן ביסודות.</p>
	<p>2. יש לחבר את משאבת החלב לצינור הסיליקון עבור שאיבה חד צדדי ולבקבוק קטן אחד.</p>
	<p>3. כאשר פלג הגוף העליון שלך קופף מעט לפנים. באפשרותן לתמוך טוב יותר בגבך שלך באמצעות שימוש בכנית.</p>
	<p>4. מקמו את מגן השד עם כרית הסיליקון בעדינות על השד. וודאו כי הפטמה מכוסה לחולטיין וכי אין כייס אויר. על מנת להבטיח תפקוד נכון, מגן השד חייב להיות מתחזק על השד.</p>
 <p>1. הפעלה מצבר גיריה 2. עוצמה</p>	<p>5. להפעלת משאבת החלב, לחצו על לחץ . משאבת החלב חייבת להיות מחוברת לצינור הסיליקון המועד לשאיבה חד צדדי ולבקבוק קטן 1. משאבת החלב תתחיל לפעול אוטומטית במצב גיריה () וטיימר של שתי דקות יופיע על גבי הציג. במהלך שתי דקות אלה, פטמת השד שלך תגורה במטירה להcinן אותה לקרהת שאיבת חלב אם. השתמשו בלחיצנים  /  לקביעת עוצמת הגיריה המבוקשת.</p>
 <p>3. התחלת שאיבה 4. עוצמה</p>	<p>6. לאחר שתי הדקות חלפו,  יתחל לhabhab על גבי הציג. לתחילת שאיבת חלב האם, לחצו על לחץ  . השתמשו בלחיצנים  /  לבירה בעוצמת הינקה הנוחה לך. הפסיקן את השימוש במשאבת ברגע שניצבו 180 מ"ל של חלב לתוך הבקבוקים.</p>



5. חזרה למצב גרייה

7. במידה וברצונך לחזור למצב גרייה, לחזו על לחץ . הגרייה והטמפרטורה של שתי דקיות יתחלו לפעול מהתחלת המשabayת החלב יש פונקציית זיכרון, הזורמת את דרגת הגרייה או את דרגת השאייבת האחורונה שתוכננה כאשר הופעלת.




8. לכיבוי משabayת החלב, לחזו על לחץ . לכיבוי משabayת החלב, לחזו על לחץ .

7.4 השימוש במשabayת ידנית



1. הוציאו את המכסה עם החיבור למשabayת החלב ותבשו את מכשיר השאייבת הידני כולל מעטפת הסיליקון באמצעות לחיצה חזקה של מעטפה הסיליקון על פני חיבור המשabayת עד להקללה במקום.




2. לאחר מכן מכוו את מגן השד עם כרית הסיליקון בעדינות על השד. וודאו כי הפטמה מכוונה להלוטין וכי אין כיס אויר. על מנת להבטיח תפקוד נכון, מגן השד חייב להיות מתחם היטב על השד. השתמשו במשabayת הידנית כמפורט באירוע.



3. אפשרותך לשנות את עוצמת השאייבת באמצעות בחירה בין מצבי MAX/MIN הנראים לעין.

7.5 אחסון חלב האם השאוב

- חלב אם שאוב ניתן לאחסן במקרר או במקפיא למשך פרקי זמן מסוימים.
- בעת אחסנת חלב אם, אנא וודאו כי משabayת החלב והבקבוקים מחוטאים טרם השימוש. אחסנו חלב אם שאוב בכלים מחוטאים בלבד.
- אחסנו חלב אם שאוב במקרר או במקפיא מיד לאחר שאיבתו. אין להשאיר חלב אם בחוץ בטמפרטורת חדר.
- במקרה של אחסנת חלב אם במקפיא, מומלץ לסמן על הבקבוק את תאריך שאיבת החלב.



שיםו לב לפרק זמן האחסון המופיעים בטבלה שלהלן:

טמפרטורת חדר	מקיר (0°C - 5°C לעיר)	מקפיא (16°C - 1°C לעיר)	זמן אחסון
ניתן לשמר במשך 24 שעות (אין לאחסן בדלת המקרר כיוון שהטמפרטורה במיקום זה אינה קרה מספיק)	ניתן לשמר במשך 3 חודשים	ניתן לשמר במשך 24 שעות (אין לאחסן בדלת המקרר כיוון שהטמפרטורה במיקום זה אינה קרה מספיק)	חלב אם שנשאב לאחורונה
10 שעות	אין להקפיא בשנית	שימי מיידי	חלב אם מופשי (אשר עבר הקפאה)

i שימוש לב

- באפשרותכם לעשות שימוש בבקבוק שסופק לכם עם פטמת הסיליקון בעת האכלת/am. להליפין, אפשרותן לשאוב את חלב האם בעזרת בקבוק NUK או Avent טרם האכלת התינוק (מתאים תואם NUK/Avent).
- ולבסוף, אפשרותן לשאוב את חלב האם בעזרת בקבוק NUK או Avent טרם האכלת התינוק (מתאים תואם NUK/Avent) כולל במשלו החומר).
 - טרם האכלת/am, ועודו כי הבקבוק עבר חיטוי לפני מילויו בחלב אם שהוא באחסנה. להפרשת חלב אם, אחסנו אותו במהלך הלילה במקרר, וזאת על מנת לשמר על החומרים המזינים. ברגע שחלב האם הופר, יש לעשות בו שימוש תוך 24 שעות. חלב אם יש להפשיר רק למיים חמימים במרקם דחוסים במיוחד.
 - במידה וחלב האם יש ריח לא נעים, יש להשליכו באופן מיידי.
 - עלולים אין לחם חלב אם במירוגל כיוון שהוא עלול להתחכם באופן לא שווה ולגרום לכויה של ילדך בזמן שהוא שותה אותו.
 - במקרה של חימום חלב אם, בדקו את הטמפרטורה שלו טרם הזנת התינוק שלך.

8. מה לעשות במקרה ואtan נתקלות בעקבות

הבעיה	פתרונות אפשריים
אין פועלות יניקה ממשابت החלב.	<ul style="list-style-type: none"> בדקו כי כל החלקים של משابت החלב מורכבים כראוי. בדקו האם חיבור המשABAה ממוקם היטב על השד.
לא נשאב חלב אם.	<ul style="list-style-type: none"> בדקו כי צינור הסיליקון מוכנס למקומו כראוי, דרגת הניינקה אינה מכוונת על המינימום ומשابت החלב מופעלת. וודאו כי לא נשאר חלב בשסתום הסיליקון אשר מפריע לדירמת החלב.
שאיית חלב האם גורמת לכאבים.	<ul style="list-style-type: none"> נסו להשתחרר ולאחר מכן נסו בשנית לאחר מספר דקות. ככל שתשתמשו במשابت החלב יותר ויותר, תרגישו שפעולות שאיבת החלב פשוטה וקלה יותר. הפחיתו את דרגת הניינקה באמצעות שימוש בלחץ -. וודאו כי לא נשאר חלב בשסתום הסיליקון החוסם את זרימת החלב. במידה והכאבים מתחזקים, הייעוץ עם הרופא שלך.
חלב האם דולף מתחת לכריית הסיליקון.	<ul style="list-style-type: none"> הוציאו את כריית הסיליקון ממוקמה וחבירו אותה בשנית. ועודו כי כריית הסיליקון ממוקמת כנדרש ומאטחת בחזקה לחיבור המשABAה. השעינו את פלג הגוף העליון שלך מעט קדימה.
אחד מרכיבי משابت החלב עבר שינוי או נפגם.	<ul style="list-style-type: none"> אין לעשות שימוש בתכשיר נקי שוחק או גז' מלול סוג שהוא. בחילק מהמרקם, תנודות ניכרות בטמפרטורה יכולות לגרום נזק לפולסטיק שעל משابت החלב. במידה ואחד מחלוקת נפגם, הפסיקו את השימוש במשابت החלב.
משابت החלב אינה נדלקת.	<ul style="list-style-type: none"> וודאו כי משابت החלב מורכב כנדרש ומופעלת. וודאו כי תקע המכשיר מחובר כנדרש למשابت החלב.

מספר הפריט	הפריט
953.15	חיבור לשאבה כולל כרית סיליקון (גודל סטנדרטי), מעטפת סיליקון, שסתום סיליקון, צינור סיליקון ובקבוק כולל פקק מוגבר
163,719	בקבוק עם פטמה ומכסה לבקבוק
163,720	מתאים לבקבוק NUK & Avent
163,721	כריות סיליקון (קטנות וסטנדרטיות)
163,722	חיבור לשאבה ידנית כולל כרית סיליקון (גודל סטנדרטי)
163,723	מעמד לבקבוקים

9. השלחת המוצר

סולולות ריקות לחוטין יש להשליך בתיבות איסוף מיוחדות לכך, בנקודות מחזור או אצל ספקים של מכשירי חשמל. אתם נדרשים מבחינה חוקית להשליך את הסולולות.

הקודים שלහן מודפסים על גבי סולולות המכילות חומרים מסיקים:

Pb = סוללה המכילת עופרת.

Cd = סוללה המכילת קadmיום.

Hg = סוללה המכילת כספית.



מיסיות של שמירה על הסביבה, אין להשליך את המכשיר יחד עם הפסולת הביתיית בסיום חי' העבודה שלו. השליכו את המכשיר במקום איסוף מתאים או בנקודות מחזור מתאימה לכך. השליכו את המכשיר בהתאם לתקן EC-WEEE (השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני). במידה וועלות לכם שאלות כלשהן, אנא צרו קשר עם הרשותות המקומיות האחראיות על השלחת הפסולות.

10. נתוני טכניים


dagm	BY 70
סוג	BY 70
ספק כוח	X 1.5 X 4 וולט סולולות AA (סולולות אלקליות)
מתוך חשמל (קלט)	50/60 100-240 וולט (AC (~) הרץ)
מתוך חשמל (פלט)	6 וולט (DC) אמפר
מידות	53 X 100 X 168 מ"מ
משקל	310 גרם (ללא סולולות)
לחץ יניקה מרבי	0.32 בר
תאנו הפעלה מותרים	+5°C עד +40°C, עד 30%RH לחות יחסית (ללא עיבוי), 700-1060 hPa לחץ סביבה
תאנו אחסנה מותרים	-20°C עד +60°C, עד 95%RH לחות יחסית (ללא עיבוי), 700-1060 hPa לחץ סביבה
זמן הפעלה צפוי	500 שעות
שימוש אינטראולים	30 דקות הפעלה / 30 דקות כיבוי
סוג הגנה	המכשיר כולל הגנה כפולה ותואם לסוג הגנה 2

	תאיימות אלקטرومגנטיות בהתאם לתקן EN 60601-2-1
	דרישות בטיחות בהתאם לתקן EN 60601-1
	שימוש הילד ופרט טיפול – ציוד שתיה בהתאם לתקן EN 14350
	מכשיר לשאייבת חלב אם
	מכשיר עם ואקום עדין וזרימה נמוכה
	חלק יישומי, סוג BF. מכשיר לשימוש בהיעדר תערובות גז מתרפצות או רעלות או תחומות חנקן

ה מידע הטכני כפוף לשינויים ללא כל הודעה מראש על קר לשם עדכונים.

מכשיר זה תואם את התקן האירופאי EN 60601-2-1 וcpfuf לאמצעי זהירות מיוחדים בהקשר לתאיימת אלקטромגנטית (EMC). אנה שימו לב לכך שמערכות תקשורת HF נישאות וニידות עשויות לגרום להפרעות למכשיר זה. פרטיהם נוספים ניתן לבדוק מכתבת שירות הליקות המצוינת או מציה בסוף הוראות השימוש.

11. חלקי מרכזים

מספר דגם	LXCP12 - 06
קילט	110-240V, 50-60Hz, 0.3A max
פלט	V DC, 1 A 6
יצרן	חברת Shenzhen LongXC Power Supply בע"מ
קובטיבות של חיבור מתח DC	 
մեծած/Տօն հեռական 2	
מעטפת וכיסוי הגנה	המעטפת של החלק המרכזי מגנה על המשתמשים מפני מגע בחלקים המיכליים חשמל ח' או חלקי שועלולים להכיל חשמל ח' (לדוגמא עם האצבע, מחטף או בדיקה). אין לגעת במתופלת ובמחבר הפלט של חלק המחשבן המרכזי DC/AC באוטו הזמן.

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY INFORMATION

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions

The BY 40 Breast Pump is designed to be operated in the electromagnetic environment described below. The client or user of the BY 40 Breast Pump must ensure that the product is used in such environment.

Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	The BY 40 Breast Pump uses RF energy for its internal operation only. Consequently its RF emissions are very low and cause no interference of nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The BY 40 Breast Pump is suitable for use in all types of facilities, domestic buildings included, and in those buildings directly connected to the low voltage public electricity supply system of domestic buildings always keeping in mind what follows:
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	Caution: This apparatus/system has to be used by health care professionals only. This apparatus/system could cause radio interferences or alter operation of nearby equipment. Attenuation measures could be necessary, such as re-orienting or re-positioning of the BY 40 Breast Pump or shielding of the current position.
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Complying	

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

The BY 40 Breast Pump is designed to be operated in the electromagnetic environment described below. The client or user of the BY 40 Breast Pump must ensure that the product is used in such environment.

Immunity test	Test level	Conformity level	Electromagnetic environment - guidelines
Electrostatic discharges IEC 61000-4-2	± 6kV in contact ± 8kV in air	± 6kV in contact ± 8kV in air	Floors have to be made in wood, cement, or ceramic. If floors are coated with synthetic materials relative humidity must range at least at 30%.
Transients / Fast electric trains IEC 61000-4-4	± 2kV for power supply lines ± 1kV for input/output lines	± 2kV for power supply lines ± 1kV for input/output lines	The quality of the mains voltage should be that of a typical commercial or hospital environment.
Pulses IEC 61000-4-5	± 1kV in differential way ± 2kV in common way	± 1kV in differential way ± 2kV in common way	The quality of the mains voltage should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage holes, voltage short interruptions and variations on the power supply input lines IEC 61000-4-11	<5% U _T (>95% dip in U _T) for 0.5 cycle 40% U _T (60% dip in U _T) for 5 cycles 70% U _T (30% dip in U _T) for 25 cycles <5% U _T (>95% dip in U _T) for 5 sec	0% UT for 10 ms 40% UT for 100 ms 70% UT for 500 ms 0% UT for 5 sec	The quality of the mains voltage should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of the BY 40 Breast Pump requires continuous operations even in case of power supply cutoff, it is recommended to plug the BY 40 Breast Pump to a uninterruptible power supply or batteries.
Mains frequency magnetic field (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	Non applicable	Mains frequency magnetic field has to be at a level typical of a commercial or hospital environment.

NOTE U_T is the a.c. mains voltage before to application of the test level.

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

The BY 40 Breast Pump is designed to be operated in the electromagnetic environment described below. The client or user of the BY 40 Breast Pump must ensure that the product is used in such environment.

Immunity test	Test level IEC 60601	Conformity level	Electromagnetic environment - guidelines
Conducted RF IEC 61000-4-6	3Vrms to 150kHz from 80MHz	3Vrms to 150kHz from 80MHz	RF portable and mobile communication equipment should not be used closer than the separation distance calculated through the equation applicable to the transmitter frequency to any part of the BY 40 Breast Pump, Cables included. Recommended separation distances.
Irradiated RF IEC 61000-4-3	3V/m to 80MHz from 2,5GHz	3V/m to 80MHz from 2,5GHz	$d = 1.17 \sqrt{P}$ $d = 4 \sqrt{P} d_a$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2.33 \sqrt{P}$ 800 MHz to 2.5 GHz <p>where P is the maximum rated Watt (W) power from the transmitter as declared by the manufacturer while d is the recommended separation distance expressed in metres (m). Field intensity produced by fixed RF transmitters, as set by electromagnetic test on site a, should be lower than the conformity level of every frequency interval. b Interferences nearby the systems signalled by the following symbol could occur:</p> 

NOTE 1: For 80MHz and 800MHz, the highest frequency interval is applied.

NOTE 2: These guidelines cannot always be applied. Electromagnetic propagation is altered by absorption and reflection of facilities, objects and people.

- a. For field intensity of fixed transmitters, such as the base stations for radiophones (cellular and cordless) EN and terrestrial radiophones, radio amateur equipment, AM and FM radio and TV transmitters whose presence can not be foreseen an on-site electromagnetic test should be planned. If field intensity measured where the BY 40 Breast Pump is used exceeds the RF conformity level then the BY 40 Breast Pump has to be kept under control to check for its correct operation. If anomalies are detected, additional measures can be taken such as a reorienting or repositioning of the BY 40 Breast Pump
- b. Over the frequency interval of 150kHz - 80MHz, field intensity has to be lower than 3V/m.

**Recommended separation distances between portable or mobile radio-communication tools
and the BY 40 Breast Pump**

The BY 40 Breast Pump is designed to be operated in electromagnetic environments where RF irradiated disturbances are kept under control. The client or user of the BY 40 Breast Pump can favour electromagnetic interferences prevention by keeping a minimum distance between portable or mobile RF communication systems (transmitters) and the BY 40 Breast Pump as recommended, according to the maximum output power of radio-communication tools.

Rated maximum output power of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m		
	150 kHz to 80 MHz	80 MHz to 800 MHz	800 MHz to 2,5 GHz
0.01	$1.17 \sqrt{P}$	$4 \sqrt{P}$	$2.33 \sqrt{P}$
0.1	0.12	0.4	0.23
1	0.37	1.26	0.74
10	1.17	4.00	2.33
100	3.7	12.65	7.37
	11.70	40.00	23.3

For those transmitters whose maximum rated output power is not indicated in the above list, the recommended separation distance in metres (m) can be calculated by the equation applicable to the transmitter frequency, where P is the maximum rated output of the transmitter in Watt (W) as declared by the manufacturer.

NOTE 1: For 80MHz and 800MHz, the highest frequency interval is applied.

NOTE 2: These guidelines cannot always be applied. Electromagnetic propagation is altered by absorption and reflection of facilities, objects and people.

758216-0616

